


マニュアルⅣ：試料到着時の入力方法

- 宮崎県医師会ホームページ下部のバナー『臨床検査精度管理調査』から特設ページに入り、『参加申込と調査回答はこちらから』をクリックし、『日本臨床衛生検査技師会 精度管理事業・データ標準化事業システム JAMTQC 参加施設向けシステム』を開く。
『施設番号』と『パスワード』を入力してログインする。



- 画面右側の『回答入力メニュー』をクリックする。

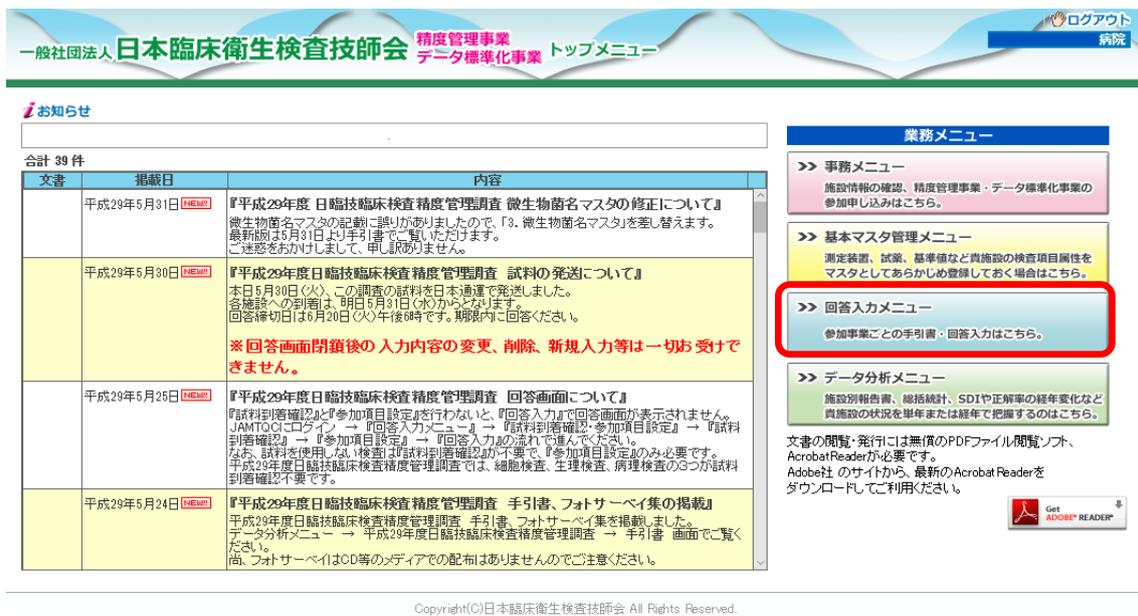

お知らせ

合計 39 件

文書	掲載日	内容
	平成29年5月31日 <small>NEW!</small>	『平成29年度 日臨技臨床検査精度管理調査 微生物菌名マスタの修正について』 微生物菌名マスタの記載に誤りがありましたので、『3. 微生物菌名マスタ』を差し替えます。 最新版は5月31日より手引書でご覧いただけます。 ご迷惑をおかけし申し訳ありません。
	平成29年5月30日 <small>NEW!</small>	『平成29年度 日臨技臨床検査精度管理調査 試料の発送について』 本日5月30日(火)、この調査の試料が日本通運で発送しました。 各施設への到着は、明日5月31日(水)からとなります。 回答締切日は6月20日(火)午後6時です。期限内に回答ください。 ※ 回答画面閉鎖後の入力内容の変更、削除、新規入力等は一切お受けできません。
	平成29年5月26日 <small>NEW!</small>	『平成29年度 日臨技臨床検査精度管理調査 回答画面について』 『試料到着確認』と『参加項目設定』を行わないと、『回答入力』で回答画面が表示されません。 JAMTQCにログイン → 『回答入力メニュー』 → 『試料到着確認』 → 『参加項目設定』 → 『試料到着確認』 → 『参加項目設定』 → 『回答入力』の流れで進んでください。 なお、試料を使用しない検査は試料到着確認が不要で、『参加項目設定』のみ必要です。 平成29年度 日臨技臨床検査精度管理調査では、細胞検査、生理検査、病理検査の3つが試料到着確認不要です。
	平成29年5月24日 <small>NEW!</small>	『平成29年度 日臨技臨床検査精度管理調査 手引書、フォトサーベイ集の掲載』 平成29年度 日臨技臨床検査精度管理調査 手引書、フォトサーベイ集を掲載しました。 データ分析メニュー → 平成29年度 日臨技臨床検査精度管理調査 → 手引書 画面でご覧ください。 尚、フォトサーベイはCD等のメディアでの配布はありませんのでご注意ください。


業務メニュー

- >> 事務メニュー
施設情報の確認、精度管理事業・データ標準化事業の参加申し込みはこちら。
- >> 基本マスタ管理メニュー
測定装置、試薬、基準値など貴施設の検査項目属性をマスタとしてあらかじめ登録しておく場合はこちら。
- >> 回答入力メニュー
参加事業ごとの手引書・回答入力はこちら。
- >> データ分析メニュー
施設別報告書、総括統計、SDIや正解率の経年変化など貴施設の状況を単年または経年で把握するのはこちら。


文書の閲覧・発行には無償のPDFファイル閲覧ソフト、Acrobat Readerが必要です。
Adobe社のサイトから、最新のAcrobat Readerをダウンロードしてご利用ください。

Copyright©日本臨床衛生検査技師会 All Rights Reserved.

3. 今年度の『宮崎県医師会臨床検査精度管理調査』を選択して、『試料到着確認・参加項目設定』をクリックする。

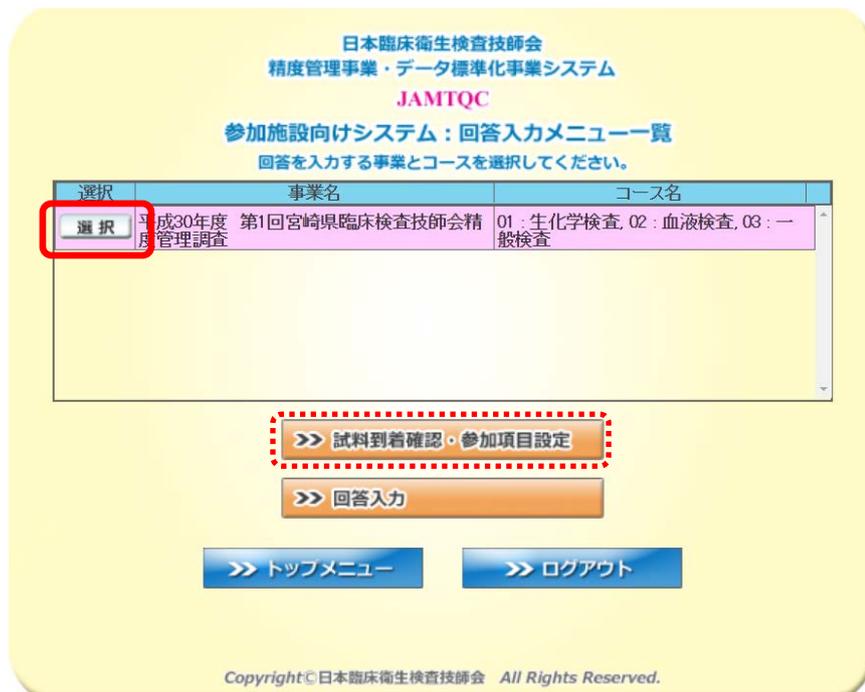

4. 『試料到着確認』画面で、『到着済』にチェックを入れた後、保存する

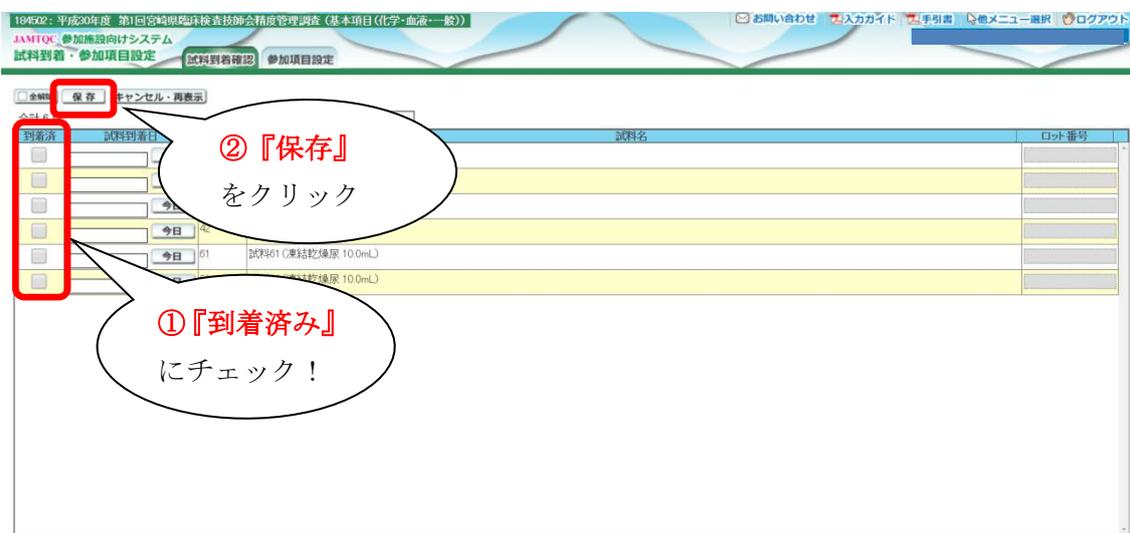

5. 『参加項目設定』タブをクリックして、参加する項目にチェックを入れて保存する。

①『参加項目設定』
タブをクリック

②『参加する項目』
にチェック！

③『保存』
をクリック

参加	評価	コード	項目名
<input type="checkbox"/>	有	101	
<input type="checkbox"/>	有	102	
<input type="checkbox"/>	有	104	
<input type="checkbox"/>	有	105	カリウム
<input type="checkbox"/>	有	106	クロール
<input type="checkbox"/>	有	107	カルシウム
<input type="checkbox"/>	有	108	無機リン
<input type="checkbox"/>	有	109	血清鉄
<input type="checkbox"/>	有	111	総蛋白
<input type="checkbox"/>	有	112	アルブミン
<input type="checkbox"/>	有	113	尿酸
<input type="checkbox"/>	有	114	尿酸窒素
<input type="checkbox"/>	有	115	クレアチニン
<input type="checkbox"/>	有	116	総コレステロール
<input type="checkbox"/>	有	117	中性脂肪

Copyright(C)日本臨床衛生検査技師会 All Rights Reserved.

6. 検査分野から自院の参加部門を選択する。

例)【一般】参加の場合↓

【尿蛋白定性】、【尿糖定性】、【尿潜血定性】にチェックを入れて「保存」をクリック。

※フォトサーベイにも参加する場合は、『一般フォト』にもチェックを入れて保存。

1

2

3

検索条件
検査分野
指定しない
臨床化学
血液
一般

項目分類
指定しない

参加	評価	コード	項目名
<input type="checkbox"/>	有	601	一般フォト
<input checked="" type="checkbox"/>	有	604	尿蛋白定性
<input checked="" type="checkbox"/>	有	605	尿糖定性
<input checked="" type="checkbox"/>	有	606	尿潜血定性

《《以上の操作を必ず行ってください》》